


REGLAGE / SETTING

1. Dévisser la vis de bridage de transport située dans le raccord process de l'appareil et laisser reposer pendant 3 heures avant de procéder à l'étalonnage.
2. Ouvrir le boîtier via la vis supérieure ① (figure 2) du couvercle
3. Dévisser partiellement la plaque de blocage ② jusqu'à pouvoir effectuer une rotation permettant d'avoir accès à la vis de réglage ③.
4. Monter l'appareil (position verticale/membrane horizontale) sur un banc de pression approprié (étendue de mesure de l'appareil : 2.5mbar).
5. Effectuer 3 cycles lents de montée en pression jusqu'à la valeur approximative du point de consigne.
6. Soumettre l'appareil à la pression de réglage désirée / visser (= sens horaire = augmentation du point de consigne) ou dévisser la vis de réglage ③, jusqu'à obtention du basculement de l'inverseur.
7. Reprendre à l'étape 6 pour valider l'étalonnage. Ajuster si nécessaire.
8. Tourner et resserrer la plaque de blocage ② et repositionner le couvercle en serrant à la main la vis supérieure ① du couvercle.


1. Unscrew the freight locking screw out of the process connection of the switch. Let the switch without any action during 3 hours before any presetting.
2. Open the cover via the upper knob ① (figure 2) of the housing.
3. Unscrew partially the locking kit ② and turn it up to access to the setting screw ③
4. Install (Vertical mounting/horizontal diaphragm) the pressure switch on a suitable bench (Full scale: 2.5mbar).
5. Operate 3 slowly cycles by increasing pressure up to the approximate value of the set point.
6. Apply to the device the requested setpoint pressure. Screw (=clockwise = increasing of the set point) or unscrew the adjustment screw ③ to obtain the switch operates.
7. Start again to the step 6 to control the setting. Then, adjust if needed.
8. Turn and tight the locking plate ②, replace the cover by screwing manually the bold ①.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE / ELECTRICAL CONNECTION

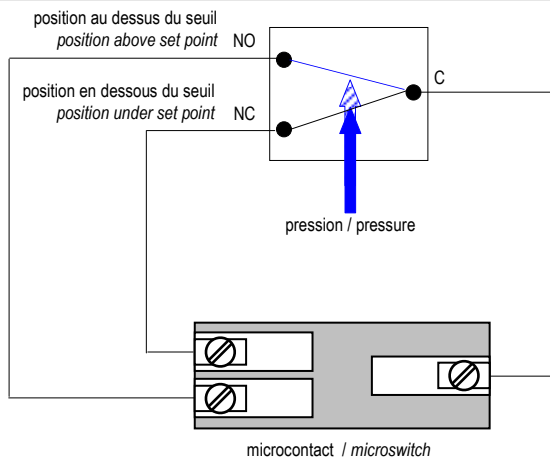


Nota : En cas de pré-réglage en usine de l'appareil, la connexion électrique se fait sur bornier / In case of presetting in our factory, the electrical connexion will be done on terminals blocks

REGLAGE / SETTING - FIGURE 1

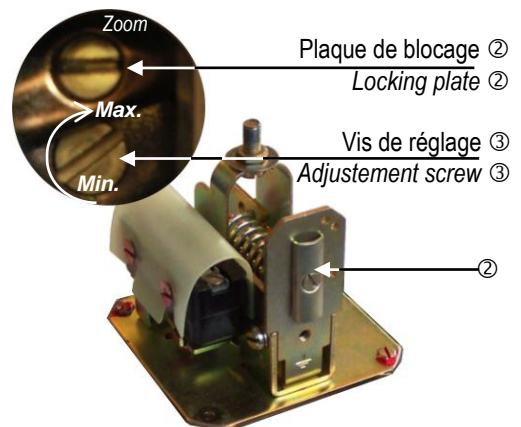

PLAN D'ENCOMBREMENT / DRAWINGS - FIGURE 2

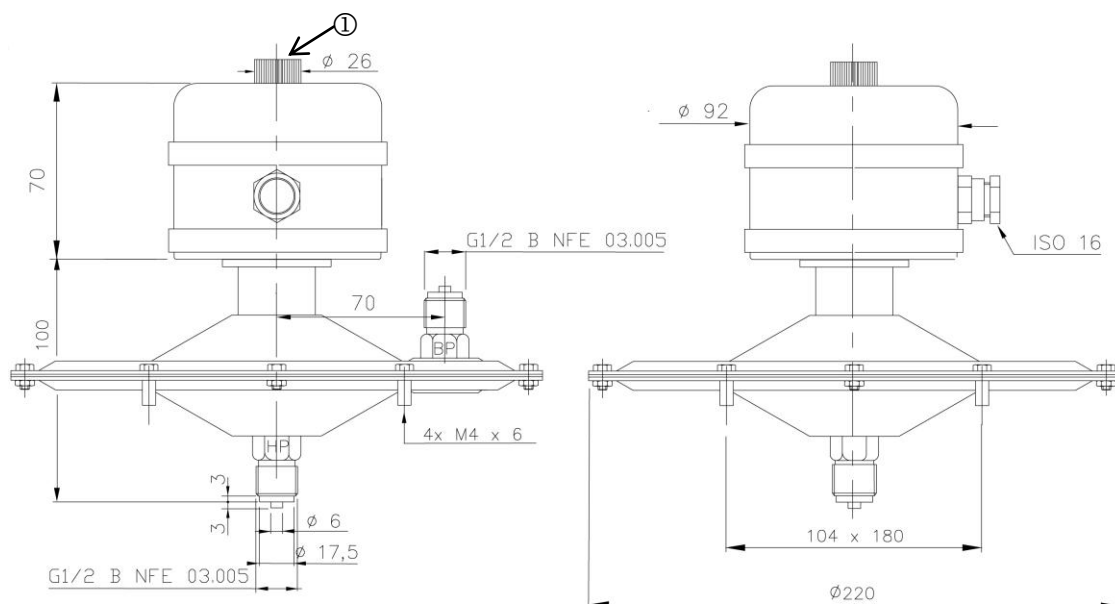

Remarques/ Notice : l'appareil doit impérativement être monté avec la membrane "à plat" / Instruments must be mounted with horizontal diaphragm.
L'appareil peut présenter une fuite minime à la partie supérieure de la membrane / Instruments may have a minor leakage on upper part of the diaphragm flange.



FRANCE
BELGIQUE

☎ : (+33) 1 46 12 60 00
☎ : (+32) 2 735 5475

☎ : (+33) 1 47 35 93 98
☎ : (+32) 2 735 1679

E mail : regulateurs@georgin.com
E mail : info@georgin.be

www.georgin.com